


CAPTEUR SPO2 NEONATE POUR MONITEUR SPENGLER 4VS



Ref. 551632

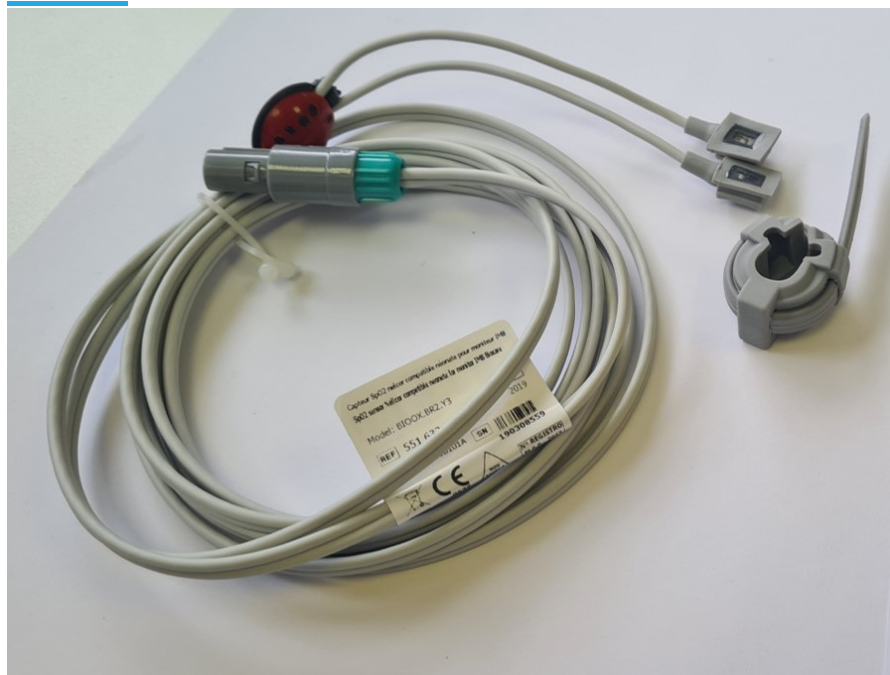

CE
0537



02/06/2025 22:03:03 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CAPTEUR SPO2 NEONATE POUR MONITEUR SPENGLER 4VS



Ref. 551632

Description

Capteur SPO2 neonate pour moniteur de signes vitaux 4 VS de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3700446031190	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	6	Pays	Uruguay
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.086
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-40	Temperature maxi	55
Humidite mini	5	Humidite maxi	95
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/06/2025 22:03:03 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.